

**AO  
ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/2024**

**ATT: PREGOEIRO(A) E/OU COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

A GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 62.413.869/0001-15, com sede em Ribeirão Preto, na Rua Martins Pena, 93, Estado de São Paulo, através da sua representante legal abaixo assinado, vem apresentar pedido de esclarecimento ao que segue abaixo:

**LOTE 04 - ITEM 04 – COLUNA OFTALMOLÓGICA**

**1º - Quanto ao valor de referência para o lote 04 – item 04 de: “R\$ 6.381,00”**

O lote 04 do edital contempla coluna oftalmológica na configuração completa, porém o valor estimado para o lote refere-se apenas a um equipamento simples, sem os acessórios solicitados no descritivo do lote 04 (Fonte de alimentação para oftalmoscópio e retinoscópio, suporte de cabos elétricos, controle dos movimentos de subida e descida da cadeira no painel da coluna, braço para lâmpada de fenda), assim não sabemos se ao efetuar a pesquisa mercadológica levou-se em consideração que tratava-se de um equipamento completo com Fonte de alimentação para oftalmoscópio e retinoscópio, suporte de cabos elétricos, controle dos movimentos de subida e descida da cadeira no painel da coluna, braço para lâmpada de fenda ou se a pesquisa encontra-se desatualizada, fato é que pelo valor estimado não é possível ofertar e entregar o equipamento na configuração que está sendo exigida pelo edital.

Com o exposto sugerimos uma atualização no valor de referência do lote, evitando que venha a ser fracassado, permitindo assim a maior competitividade e legalidade, principais objetivos almejados pelo processo licitatório.

**2º - Quanto a exigência: “...Capacidade de elevação do braço – máximo de 50kg...”**

Verifica-se que a exigência que o braço da lâmpada de fenda possua capacidade de elevação máxima de 50 kg acaba mesmo que sem intenção direcionando o item, pois os aparelhos que este braço foi projetado para suportar não pesam mais que 15 kg.

Tanto que a capacidade do braço para lâmpada de fenda varia de acordo com a marca/modelo, assim vejamos:

## COLUNA OFTALMOLÓGICA DA MARCA APRAMED



Coluna Oftalmológica Apramed - Elegance

### 4. Especificações técnicas


Tensão de alimentação.....	127/220V.a.c (Seleção Manual)
Frequência de operação.....	50 / 60 Hz
Corrente de carga.....	2A
Tipo do fusível (geral 02 peças).....	Fusível rápido 20mm – 2A – 250V
Consumo de energia.....	220VA
Motor (modelo Elegance LX).....	24V.c.c
Capacidade máxima de elevação braço lâmpada fenda.....	18 kg
Capacidade máxima de elevação braço pantográfico.....	07 kg
Capacidade máxima de elevação tampo projetor móvel...	03 kg
Tensão de saída das tomadas múltiplas.....	127/220V.a.c (conforme alimentação)
Frequência de operação das tomadas múltiplas.....	50 / 60 Hz
Valor de carga das tomadas múltiplas (individualmente)..	50VA
Dimensões do equipamento.....	1240 x 900 x 2000mm (C x L x A)
Altura máxima / mínima do tampo LF.....	935mm / 800mm
Área ocupada.....	2,31 m <sup>2</sup>
Peso líquido.....	80 kg
Peso bruto.....	100 kg
Tipo de embalagem.....	Caixa de papelão
Dimensões da embalagem.....	780 x 790 x 1250mm (C x L x A)

## COLUNA OFTALMOLÓGICA DA MARCA GIGANTE

6.7. CARGAS MÁXIMAS	
Bandejas Auxiliares	10 Kg
Braço Pantográfico	7 Kg
Braço para Lâmpada de Fenda	25 Kg

## COLUNA OFTALMOLÓGICA DA MARCA XENONIO

Não localizado através do link <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351423684202289/?cnpj=39322587000190> o manual de uso através do registro na Anvisa, não sendo possível confirmar a informação quanto a capacidade.

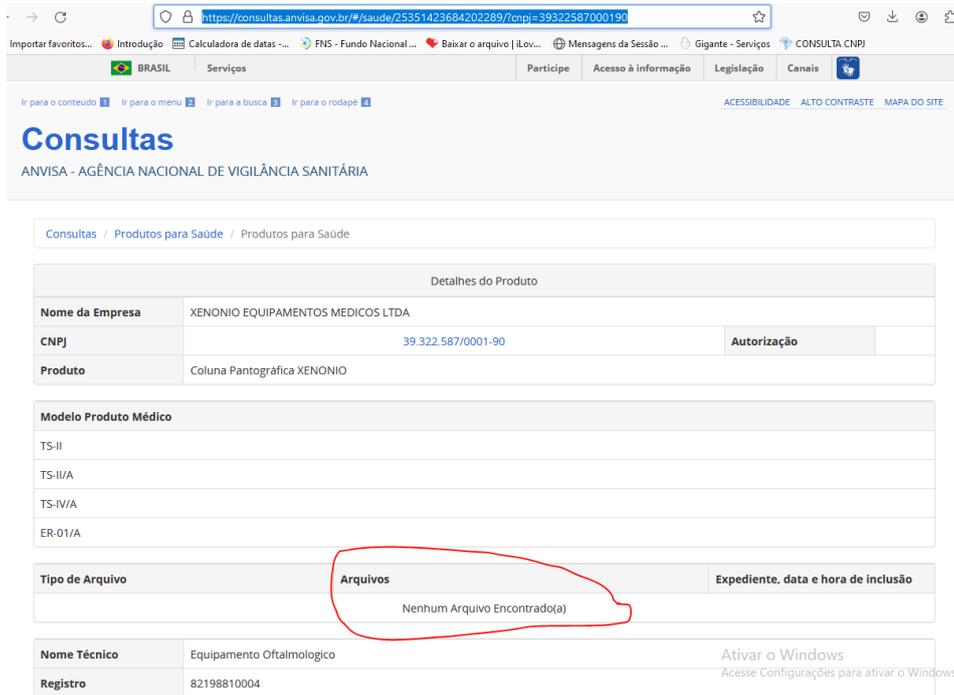

The screenshot shows the ANVISA website interface. The main heading is 'Consultas' and the sub-heading is 'ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA'. The breadcrumb trail is 'Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde'. The 'Detalhes do Produto' section contains the following information:

Nome da Empresa	XENONIO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
CNPJ	39.322.587/0001-90	Autorização
Produto	Coluna Pantográfica XENONIO	

The 'Modelo Produto Médico' section lists the following models: TS-II, TS-II/A, TS-IV/A, and ER-01/A.

The 'Tipo de Arquivo' section has a table with the following content:

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
	Nenhum Arquivo Encontrado(a)	

The 'Arquivos' column header and its content are circled in red in the original image. At the bottom, the 'Nome Técnico' is 'Equipamento Oftalmológico' and the 'Registro' is '82198810004'. There is also a Windows watermark: 'Ativar o Windows. Acesse Configurações para ativar o Windows.'

Diante ao exposto podemos concluir que a capacidade do braço para lâmpada de fenda varia de acordo com a marca, porém as principais fabricantes possuem capacidade máxima de 25 kg, ou seja, exigir a “capacidade de elevação máxima de 50kg” apenas restringe a participação e a oferta, ferindo os Princípios da Isonomia, Economicidade, Competitividade e Legalidade almejados pelo processo licitatório.

Destaca-se que a Coluna Oftalmológica trata-se de um equipamento eletromédico devendo ser certificado junto as Normas NBR (Inmetro), comprovando sua total estabilidade, segurança e funcionalidade.

Assim, diante ao exposto, solicitamos esclarecimento se será aceito pelo órgão braço para lâmpada de fenda com “**capacidade de elevação inferior a 50 kg**”, ressaltamos que o equipamento em si não pesa mais que 15 kg, permitindo assim a maior competitividade e legalidade, principais objetivos almejados pelo processo licitatório.

Sem mais para o momento, aguardamos retorno e nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário.

Ribeirão Preto, 16 de julho de 2024.

Érica Vernile Pereira Vezono  
 RG. 18.294.531-5-SSP/SP  
 CPF: 138.771.588-70

